Etch-Rite™

DENTAL ETCHING GEL

38% Phosphoric Acid

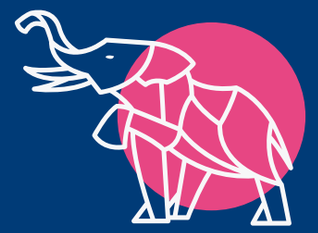

Etch-Rite is a thixotropic phosphoric acid etch gel that stays in place and will not run onto exposed tissue. Syringe dispensing through pre-bent small gauge applicator tips offers precise placement of gel even in relatively inaccessible areas. Etch-Rite washes off easily with water.

CE 0459

XP-ETCH-IN-02
REV: 10/2023

PULPDENT®

PRODUCT DESCRIPTION
38% phosphoric acid dental etching gel

INDICATIONS
For acid etching dentin, enamel and glass ionomer cement

CONTRAINDICATIONS
Do not place on soft tissues

DIRECTIONS FOR USE
1. Prepare tooth and cleanse the enamel surface to be etched with a slurry of pumice or non-oil containing prophy paste. Rinse and dry thoroughly.
2. Securely attach 25-gauge luer lock applicator tip to syringe. Start flow on pad; not in patient's mouth. Do not push on plunger with thumb. For safe, controlled dispensing, rest plunger in palm of hand and pull back on syringe barrel with thumb, index and middle fingers. Do not force plunger down into barrel.
3. Recommended etching time for enamel is 15-20 seconds and for dentin is 15 seconds. To the extent possible, apply Etch-Rite first to enamel and then to dentin. Leave on dentin for 15 seconds. Cap syringe immediately after use.
4. Rinse off Etch-Rite with copious amounts of water. Do not disturb this surface.
5. Leave surface wet, or dry surface with clean, uncontaminated air, depend¬ing on the instructions for use for the bonding system you are using.

Note: Etched enamel should appear chalky white. If not, reapply etch gel to enamel for 20 seconds and rinse with copious amounts of water.

WARNING:
If Etch-Rite contacts skin or soft tissue, rinse off immediately with copious amounts of water.

STORAGE AND HANDLING
- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination and sources of ignition.
- Shelf life of unopened product: 2 years from date of manufacture.
- Re-cap immediately after use.

REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS
Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
email: pulpdent@pulpdent.com
Note: Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: https://www.fda.gov/ medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices
Note: Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

ESPAÑOL

Etch-Rite ™
Gel de Grabado Dental - Ácido fosfórico al 38 %

Descripción del producto
Gel de grabado dental con acido fosfórico al 38 %

Indicaciones
Gel de grabado ácido para dentina, esmalte y cemento de vidrio ionómeros

Contraindicaciones
No está indicado para la colocación sobre tejidos blandos.

Instrucciones de uso
1. Preparar el diente y limpiar la superficie de esmalte para ser grabada con una lechada de piedra pómez o con pasta de profilaxis no oleosa. Lavar y secar a fondo.
2. Colocar la punta predoblada Luer Lock de calibre 25 en la jeringa. Inicie el flujo en la almohadilla; no en la boca del paciente. No presione el émbolo con el pulgar. Para una dispensación segura y controlada, coloque el émbolo en la palma de la mano y tire hacia atrás del cilindro de la jeringa con los dedos pulgar, índice y medio. No fuerce el émbolo hacia el interior del cañón.
3. El tiempo recomendado de grabado para esmalte es 15-20 segundos y para dentina 15 segundos. Dentro de lo posible, aplicar primero en esmalte y luego en dentina, dejándola por 15 segundos en esta última. Cambie la jeringa inmediatamente después de su uso.
4. Lavar Etch-Rite con abundante agua. No tocar la superficie.
5. Dejar la superficie húmeda o secar con aire limpio y no contaminado, dependiendo del sistema adhesivo que esté utilizando.

Nota: El esmalte grabado debe verse color tiza. Si no, reaplicar el gel al esmalte por 20 segundos y lavar con abundante agua.

Advertencia:
Si el gel entra en contacto con manos o mucosa, lavar inmediatamente con abundante agua.
Almacenamiento y Manipulación
- Almacene bien cerrado en el contenedor original a temperatura ambiente. Evite la luz directa, los extremos de temperatura, contaminación y fuentes de ignición.
- Vida útil del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Volver a tapar inmediatamente después de su uso.

Reporte de incidentes graves
Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado.
Los informes de incidentes graves deben enviarse a:
Corporación Pulpdent
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
correo electrónico: pulpdent@pulpdent.com
Nota: Utilice fundas/envolturas de barrera desechables sobre los dispensadores dentales de uso múltiple antes de usarlos con cada paciente. Para obtener información adicional, consulte: https://www.fda.gov/ medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices.
Nota: Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

FRANÇAISE

PULPDENT®

Etch-Rite™
Gel de Mordançage - 38 % Acide Phosphorique

Description du Produit
Gel de mordançage à 38 % d'acide phosphorique.

Indications
Pour mordancer la dentine, l'émail et les ciments verre ionomère.

Contre-indications
Non indiqué pour un placement sur les muqueuses.

Instructions d'Utilisation
1. Préparer la dent à mordancer et nettoyer l'émail avec une pâte prophylactique sans huile ou une solution contenant de la ponce. Rincer abondamment et sécher.
2. Fixer solidement l'embout applicateur Luer Lock de calibre 25 à la seringue. Démarrer le flux sur le tampon ; pas dans la bouche du patient. Ne pas appuyer sur le piston avec le pouce. Pour une distribution sûre et contrôlée, placer le piston dans la paume de la main et tirer sur le corps de la seringue avec le pouce, l'index et le majeur. Ne pas forcer le piston vers le bas dans le canon.
3. Le temps de mordançage recommandé pour l'émail est de 15 à 20 secondes et pour la dentine de 15 secondes. Dans la mesure du possible, appliquer d'abord Etch-Rite sur l'émail puis sur la dentine. Laisser sur la dentine pendant 15 secondes. Boucher la seringue immédiatement après utilisation.
4. Rincer Etch-Rite avec de grandes quantités d'eau. Ne pas déranger cette surface.
5. Laisser la surface humide ou la sécher avec de l'air propre et non contaminé, selon les instructions du produit de collage utilisé.

Remarque : l'émail gravé doit apparaître d'un blanc crayeux. Sinon, appliquer à nouveau le gel de mordançage sur l'émail pendant 20 secondes et rincer abondamment à l'eau.

Mise en garde
Si Etch-Rite entre en contact avec la peau ou les muqueuses, rincer immédiatement abondamment avec de l'eau.

Stockage et Manipulation
- Conserver hermétiquement clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Eviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.
- Validité du produit non ouvert : 2 ans à partir de la date de fabrication.
- Reboucher immédiatement après l'usage.

Notification des incidents graves
Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié.
Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à :
Société Pulpdent
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis
Tél. : 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262
courriel : pulpdent@pulpdent.com
Remarque : Appliquer des protections jetables et remplacer l'embout avant de l'utiliser avec chaque patient. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web https://www.fda.gov/ medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices
Remarque : Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

DEUTSCH

PULPDENT®

Etch-Rite™
Zahnätzgel – 38% Phosphorsäure

PRODUKTBESCHREIBUNG
38% Phosphorsäure Zahnätzgel

ANGABEN
Zum Ätzen von Dentin, Schmelz und Glasionomerzement

KONTRAINDIKATIONEN
Nicht auf Weichgewebe anbringen.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Zahn vorbereiten und die zu ätzende Zahnschmelzoberfläche mit einer Aufschlämmung aus Bimsstein oder nicht ölhaltiger Prophylaxepaste reinigen. Gründlich abspülen und trocknen.
2. Befestigen Sie die 25-Gauge-Luer-Lock-Applikatorspitze sicher an der Spritze. Starten Sie die Ausgabe auf einem Pad; nicht im Mund des Patienten. Drücken Sie nicht mit dem Daumen auf den Kolben. Für sicheres, kontrolliertes Dosieren Kolben in der Handfläche auflegen und am Spritzenlauf mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger zurückziehen. Den Kolben nicht in den Lauf zwingen.
3. Die empfohlene Ätzzeit für Zahnschmelz beträgt 15-20 Sekunden und für Dentin 15 Sekunden. Soweit möglich, wenden Sie Etch-Rite zuerst auf den Zahnschmelz und dann auf das Dentin an. 15 Sekunden auf Dentin einwirken lassen. Verschlussspritze sofort nach Gebrauch.
4. Etch-Rite mit reichlich Wasser abspülen. Stören Sie diese Oberfläche nicht.
5. Lassen Sie die Oberfläche nass oder trocken mit sauberer, unverschmutzter Luft, abhängig von der Gebrauchsanweisung für das von Ihnen verwendete Bonding-System.

Hinweis: Geätzter Zahnschmelz sollte kalkweiß erscheinen. Wenn nicht, ätzen Sie erneut für 20 Sekunden und spülen Sie das Gel mit reichlich Wasser ab.

WARNUNG:
Wenn Etch-Rite mit Haut oder Weichgewebe in Berührung kommt, sofort mit reichlich Wasser abspülen.

LAGERUNG UND HANDHABUNG
- Dicht verschlossen im Originalbehälter bei kühler Raumtemperatur lagern. Vermeiden Sie direktes Licht, extreme Temperaturen, Verunreinigungen und Zündquellen.
- Haltbarkeit des ungeöffneten **Produkts:** 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Sofort nach Gebrauch wieder verschließen.

MELDUNG SCHWERWIEGENDER VORFÄLLE
Alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die das Produkt betreffen, sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich der Sicherheitsvorfall ereignet hat, oder einer anderen geeigneten Regulierungsstelle gemeldet werden. Meldungen über schwerwiegende Vorfälle sind zu richten an:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 Vereinigte Staaten von Amerika
Tel.: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
E-Mail: pulpdent@pulpdent.com
Hinweis: Bringen Sie vor der Verwendung bei jedem Patienten Einweg-Barriereschutzhüllen/-wicklungen über zahnärztlichen Mehrwegspendern an. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fda.gov/ medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices
Hinweis: Eine Liste der in diesem Produkt vorhandenen Materialien finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

ITALIANO

Etch-Rite™
Gel Mordenzante Dentale - 38% acido fosforico

Descrizione del prodotto
Gel mordenzante dentale con acido fosforico al 38%

Indicazioni
Per la mordenzatura di dentina, smalto e cemento vetroionomero

Controindicazioni
Non indicato per l'applicazione sui tessuti molli.

Istruzioni per l'uso
1. Preparare il dente e pulire la superficie dello smalto da mordenzare con un impasto di pomice o una pasta profilattica priva di olio. Risciacquare e asciugare accuratamente.
2. Posizionare bene il puntale d'applicazione luer lock calibro 25 sulla siringa; iniziare a far colare

il gel su un tampone - non nella bocca del paziente. Non premere lo stantuffo con il pollice. Per un'applicazione sicura e controllata, posizionare lo stantuffo nel palmo della mano e tirare la siringa con pollice, indice e dito medio.
3. Il tempo di mordenzatura consigliato per lo smalto è di 15-20 secondi e di 15 secondi per la dentina. Per quanto possibile, applicare Etch-Rite prima sullo smalto e poi sulla dentina. Lasciare sulla dentina per 15 secondi. Tappare la siringa immediatamente dopo l'uso.
4. Sciacquare Etch-Rite con abbondante acqua. Non contaminare questa superficie.
5. Lasciare la superficie bagnata o asciugarla con aria pulita e non contaminata, a seconda delle istruzioni d'uso del sistema adesivo che si sta utilizzando.

Nota: Lo smalto mordenzato dovrebbe apparire bianco gessoso. In caso contrario, riapplicare il gel mordenzante sullo smalto per 20 secondi e risciacquare con abbondante acqua.

Avvertimento:
In caso di contatto di Etch-Rite con pelle o tessuti molli, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.

Conservazione e gestione
- Conservare nel contenitore originale ben sigillato a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di ignizione.
- Periodo di validità del prodotto non aperto: 2 anni dalla data di produzione.
- Richiudere immediatamente dopo l'uso.

Segnalazione di incidenti gravi
Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Applicare delle protezioni monouso sulla siringa e cambiare il puntale dopo ogni paziente
Per ulteriori informazioni vedere: https://www.fda.gov/ medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices

Nota: Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.

DANSK

PULPDENT®

Etch-Rite
Dental Etching Gel — 38 % fosforsyre
Etch-Rite er en tixotrop ætsgel med fosforsyre, der bliver siddende og ikke løber ud på blotlagt væv. Gelen dispenseres med en sprøjte gennem en smal, vinklet applikatorspids, der sikrer præcis placering af gelen, selv på relativt utilgængelige områder. Etch-Rite kan nemt skylles af med vand.

PRODUKTBESKRIVELSE
38 % fosforsyre, dental ætsgel

INDIKATIONER
Ætsning af dentin, emalje og glasionomercement

KONTRAINDIKATIONER
Må ikke lægges på blødt væv.

BRUGERVEJLEDNING
1. Præparer tanden, og rens den emaljeflade, der skal ætses, med en opslæmning af pimpsten eller oliefri profylaksepasta Skyl efter og tør grundigt.
2. Sæt en 25G luer-lock applikatorspids fast på sprøjten. Start flowet på en blok, og ikke i patientens mund. Skub ikke på stemplet med tommelfingeren. Stemplet skal hvile i håndfladen, og sprøjtecylinderen trækkes tilbage med tommel-, pege- og midterste finger for at opnå en sikker og kontrolleret applicering. Stemplet må ikke presses ned i cylinderen.
3. Den anbefalede ætsetid for emalje er 15-20 sekunder og for dentin 15 sekunder. Så vidt muligt skal Etch-Rite først appliceres på emaljen og derefter på dentinen. Lad gelen sidde på dentinen i 15 sekunder. Sæt hætten tilbage på sprøjten straks efter brug.
4. Skyl Etch-Rite af med rigelige mængder vand. Den ætsede overflade må ikke berøres.
5. Lad overfladen være våd, eller tør den med ren, ukontamineret luft, afhængigt af brugsanvisningen til det adhæsivsystem, der skal anvendes.

Bemærk: Ætset emalje skal se kridtagtigt ud. Hvis det ikke er tilfældet, skal emaljen ætses i 20 sekunder igen og skylles med rigelige mængder vand.

ADVARSEL:
Hvis Etch-Rite kommer i kontakt med hud eller blødt væv, skal det omgående skylles af med rigelige mængder vand.

OPBEVARING OG HÅNDTERING
- Opbevares tæt forseglet i den oprindelige beholder ved kølig stuetemperatur. Undgå direkte lys, ekstreme temperaturer, kontaminering og antændelseskilder.
- Holdbarhed af uåbnet produkt: 2 år fra fremstillingsdatoen.
- Sæt hætten på igen umiddelbart efter brug.

INDBERETNING AF ALVORLIGE HÆNDELSER
I tilfælde af alvorlige hændelser, der involverer produktet, skal du underrette producenten og den kompetente myndighed i dit land. Rapporter om alvorlige hændelser skal sendes til:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tlf: +1-617-926-6666 / Fax: +1- 617-926-6262
e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Bemærk: Anbring hygiejneovertræk til engangsbrug over dispensere til flere formål, før de tages i brug til hver patient. For yderligere oplysninger henvises til: https://www.fda.gov/ medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices

Bemærk: Se sikkerhedsdatabladet for at få en liste over de materialer, der findes i dette produkt.

NEDERLAND

PULPDENT®

Etch-Rite™
Tandheelkundige Etch-Rite — 38% fosforzuur
Etch-Rite is een thixotrope fosforzuur-etsgel die op zijn plaats blijft en niet op blootliggend weefsel loopt. Spuitdosering via voorgebogen kleine applicatortips zorgt voor een nauwkeurige plaatsing van de gel, zelfs op relatief ontoegankelijke gebieden. Etch-Rite wast gemakkelijk af met water.

PRODUCTBESCHRIJVING
38% fosforzuur tandheelkundige etsgel

INDICATIES
Voor het met zuur etsen van dentine, glazuur en glasionomeercement

CONTRA-INDICATIES
Niet op zachte weefsels plaatsen

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Bereid de tand voor en reinigt het glazuuroppervlak dat moet worden geëtst met een slurry van puimsteen of een niet-oliehoudende profylaxe. Spoel en droog grondig.
2. Bevestig de 25-gauge luer-lock applicatortip stevig op de spuit. Start stroom op pad; niet in de mond van de patiënt. Duw niet met uw duim op de zuiger. Voor een veilige, gecontroleerde dosering, laat u de zuiger in de handpalm rusten en trekt u de spuitcilinder met duim, wijs- en middelvinger terug. Forceer de zuiger niet in de loop.
3. De aanbevolen etstijd voor glazuur is 15-20 seconden en voor dentine 15 seconden. Breng Etch-Rite, voor zover mogelijk, eerst aan op het glazuur en daarna op het dentine. Laat op dentine gedurende 15 seconden. Dop de spuit onmiddellijk na gebruik af.
4. Spoel Etch-Rite af met ruime hoeveelheden water. Verstoor dit oppervlak niet.
5. Laat het oppervlak nat of droog met schone, niet-verontreinigde lucht, afhankelijk van de gebruiksaanwijzing van het lijmsysteem dat u gebruikt.

Opmerking: geëtst email moet krijtwit lijken. Als dit niet het geval is, breng dan gedurende 20 seconden opnieuw etsgel aan op het glazuur en spoel af met ruime hoeveelheden water.

WAARSCHUWING:
Als Etch-Rite in contact komt met de huid of zacht weefsel, spoel dan onmiddellijk af met ruime hoeveelheden water.

OPSLAG EN HANTERING
- Bewaar goed afgesloten in de originele verpakking op een koele kamertemperatuur. Vermijd direct licht, extreme temperaturen, vervuiling en ontstekingsbronnen.
- Houdbaarheid van ongeopend product: 2 jaar vanaf fabricagedatum.
- Sluit de dop direct na gebruik weer af.

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN
Alle ernstige incidenten waarbij het hulpmiddel betrokken is, moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waar het incident heeft plaatsgevonden, of aan een andere bevoegde regelgevende instantie. Meldingen van ernstige incidenten moeten worden gestuurd naar:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 VS
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Opmerking: Breng vóór gebruik bij elke patiënt wegwerpbare barrièrehoezen/-wikkels aan over tandheelkundige dispensers voor meervoudig gebruik. Raadpleeg voor meer informatie: https://www.fda.gov/ medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices

Opmerking: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor een lijst van materialen in deze Product.

SVENSKA

Etch-Rite

PRODUKTBESKRIVNING
38% fosforsyra, dental Etch-Rite

INDIKATIONER
För syraetsning av dentin, emalj och glasjonomercement.

KONTRAINDIKATIONER
Applicera inte på mjukvävnad.

BRUKSANVISNING
1. Preparera tand och rengör de ytor som ska etsas med pimpsten eller oljefri putspasta. Skölj och torka.
2. Applicera en 25G luer-lock applikationskanyl på sprutan. Tryck först ut material på ett block; ej i patientens mun. Tryck inte på kolven med tummen. För säker, kontrollerad dosering, vila kolven i handflatan och dra tillbaka sprutcylindern med tummen, pekfingret och långfingrarna. Tvinga inte ned kolven i cylindern med kraft.
3. Rekommenderad etsningstid för emalj är 15-20 sekunder och 15 sekunder för dentin. Applicera i möjligaste mån etgel på emalj först och sedan på dentin. Etsa dentin i 15 sekunder. Sätt på korken på sprutan omedelbart efter användning.
4. Skölj av Top Dent Etch-Rite med stora mängder vatten. Rör inte etsad tandyta.
5. Lämna ytan våt eller torka ytan med ren luft, beroende på vad som anges i bruksanvisningen för det adhesivsystem som används.

Obs: Etsad emalj ska se kritvit ut. Om inte, applicera Etch-Rite på emaljen igen i 20 sekunder och skölj med stora mängder vatten.

VARNING:
Om Top Dent Etch-Rite kommer i kontakt med hud eller mjukvävnad, skölj omedelbart med stora mängder vatten.

LAGRING OCH HANTERING
- Förvaras tätt försluten i originalförpackningen vid sval rumstemperatur. Undvik direkt ljus, extrema temperaturer, föroreningar och antändningskällor.
- Hållbarhet för oöppnad produkt: 2 år från tillverkningsdatum.
- Sätt på kork omedelbart efter användning.

RAPPORTERING AV ALLVARLIGA INCIDENTER/TILLBUD
Alla allvarliga incidenter som involverar produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där händelsen inträffade eller till annat lämpligt tillsynsorgan. Rapporter om allvarliga incidenter ska skickas till:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
email: pulpdent@pulpdent.com

Obs: Applicera engångsbarriärskydd över dispenseringsutrustning för flergångsbruk, före användning på patient. För mer information, se: https://www.fda.gov/ medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices

Not: Se säkerhetsdatablad för en lista över material/ämnen som finns i denna produkt.

Leibetseder Dentalwarenhandel GmbH
Hans-Zach-Straße 2
4210 Gallneukirchen
Austria

Bohumila Sieglová
Kolmá 303
25203 Řitka
Czech Republic

Hu-Fa Dental a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice
Czech Republic

Cenger Scandinavia A/S
Urlevvej 6 B
8783 Hornsyld
Denmark

Dansk Nordenta A/S
Nydamsvej 8
8362 Hørning
Denmark

Plandent OY
Asentajankatu 6 B
00880 Helsinki
Finland

OPSYSE
18 Allée du Fenouil
ZA Saint Louis
84250 Le Thor
France

KinderDent GmbH
Gutenbergstraße 7
28844 Weyhe
Germany

Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg im Allgäu
Germany

Dental Medical Ireland
Kellystown House
Kellystown Lane,
Leixlip
Co. Kildare, W23 VF9P
Ireland

Ravelli S.p.A.
Via Darwin 32-34
20019 Settimo Milanese
Italy

Virdental, UAB
Artojų g. 52B,
Garliavos Apylinkių seniūnija
Teleičių kaimas
53273, Kauno Rajonas
Lithuania

Hofmeester Dental B.V.
Andries Copierhof 2
3059 LM Rotterdam
Netherlands

Equadent Sp z o.o.
ul. Pck 12
62-500 Konin
Poland

Lifco Dental AB
Verkmästaregatan 1
745 39 Enköping
Sweden

UNIDENT AB
Västerhavsvägen 2
311 77 Falkenberg
Sweden

SAFETY DATA SHEET
PULPDENT®
SCAN ME
www.pulpdent.com/info

PULPDENT® Corporation
80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.
(617) 926-6666 or (800) 343-4342 • Fax (617) 926-6262
www.pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com

Rx ONLY 5°C 27°C USA